

# *Рабочий проект*

## *Система палатной сигнализации HostCall-CMP с разговорным трактом*

*Заказчик: ООО "СпецСтройМонтаж"*

*Объект: кардиологическое отделение ЦРБ г. Озеры*

*Адрес:*

*Московская обл., г. Озеры, ул. Сосенский стан, д. 10/1*

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

Лист	Наименование					Примечание										
Перв. примен.	1	Титульный лист														
	2	Ведомость рабочих чертежей														
	3	Общие указания														
	4	Исходные данные и обоснование применяемого оборудования														
	5	Основные проектные решения														
Справ. N	6	Принцип работы системы "HostCall-CMP"														
	8	Электропитание														
	9	План расположения оборудования														
	10	Структурная схема соединений														
	12	Структурная схема соединений палаты на 4 койко-места														
	13	Структурная схема соединений палаты на 2 койко-места														
	14	Структурная схема соединений VIP-палаты на 1 койко-место														
	15	Структурная схема соединений (оборудование входной группы)														
	16	Внешний вид оборудования														
	17	Спецификация оборудования														
Инв. N подл.	Погп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Погп. и дата	Инв. N подл.	Изм.	Лист	N докум.	Погп.	Дата	Система палатной сигнализации "HostCall-CMP" с разговорным трактом					Лист
																2

Общие указания

Техническое задание на проектирование является основанием для выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации для комплектации и монтажа системы палатной сигнализации в ЦРБ г. Озеры, расположенной по адресу: Московская обл., г. Озеры, ул. Сосенский Стан, д. 10/1. В объёмы выполняемых работ, предусмотренных «Заданием на проектирование», входит разработка разделов проектной и рабочей документации для кардиологического отделения больницы в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и исходными данными Заказчика.

Целью проекта является создание системы вызывной Палатной сигнализации кардиологического отделения ЦРБ г.Озеры. Система вызывной сигнализации предназначена для автоматизации процессов обслуживания пациентов. Система должна представлять собой комплекс программно-аппаратных средств и должна быть предназначена для повышения качества медицинской помощи за счет комплексной автоматизации взаимодействия персонала и пациентов в больнице. Создание системы вызывной сигнализации должно обеспечить повышение эффективности деятельности больницы за счет охвата основных этапов взаимодействия персонала и пациентов в лечебном процессе, своевременного получения достоверной информации о деятельности персонала больницы в ходе лечебного процесса, а также оперативной статистической отчетности.

Также в проекте предусмотрена установка световых маяков на входе и выходе из отделения. Данные маяки предназначены для обеспечения доступности в помещения маломобильных групп населения и инвалидов, и обеспечивают условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по территории здания.

Нормативно-технические документы:

- ВСН 60-89 «Устройство связи, сигнализации и диспетчеризации жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».
- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;
- ВСН 604-III-87 «Техника безопасности при монтаже технологического оборудования»;
- Р 78.36.009-99 «Рекомендации по комплексным системам»;
- РМ-2798 «Инструкция по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства»;
- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
- ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы;
- Международный формат ISO/IEC 11801 - Information Technology. Generic Cabling for Customer Premises - Информационная технология. Обобщенная кабельная система для зданий (Стандарт определяет требования к СКС кат. 5);
- ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;
- ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации;
- СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
- СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения

Перв. примен.	Справ. N	Погр. и дата	Инф. N субли.	Взам. инв. N	Погр. и дата	Инв. N подл.	<i>Система палатной сигнализации "HostCall-CMP" с разговорным трактом</i>					Лист
							Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата	3

**Исходные данные для разработки системы вызывной палатной сигнализации:**

В больнице необходимо спроектировать систему, которая позволит медицинскому персоналу осуществлять звуковой и визуальный контроль над вызовами пациентов. Необходимо чтобы система обеспечивала однозначную идентификацию вызова пациента.

Система палатной сигнализации должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- Регистрацию на сервере больницы поступающих вызовов и действий персонала;
- Прием поступающих вызовов на пульт дежурной медсестры;
- Световую и звуковую индикацию на пульт поста дежурной медсестры стандартных и экстренных вызовов из санузла, информирование о присутствии медперсонала в палате, информацию о вызове врача;
- Дублирование поступающих вызовов, присутствия персонала, вызовов врача для каждой палаты в коридоре на табло дублирования вызовов и над дверью у каждой палаты со световой индикацией на коридорной лампе;
- Дублирование стандартных и экстренных вызовов из санузла, а также присутствия персонала в палате на смартфонах сотрудников.
- Дублирование стандартных и экстренных вызовов из санузла на кнопочные мобильные телефоны сотрудников отделения в виде СМС-сообщений;
- Организацию голосовой переговорной связи между постом медсестры и койко-местами пациентов, а также помещением ординаторской;
- Организацию домофонной связи между постом медсестры и помещением перед входной дверью в отделение с возможностью контроля доступа в отделение;
- Вызов врача из каждой палаты посредством кнопки вызова врача;
- Световую и звуковую индикацию на табло отображения в ординаторской вызовов врача и присутствия медперсонала в палате;
- Установка в палатах выносных проводных кнопок вызова для лежачих больных;
- Установка в туалетных и душевых комнатах влагозащищенных проводных кнопок экстренного вызова;
- Сброс всех вызовов в палате дежурным медперсоналом из одной точки палаты;
- Объектом внедрения системы является кардиологическое отделение ЦРБ г. Озеры.

Отделение расположено на третьем этаже и имеет 14 палат на 35 пациентов, включая:

- пост дежурной медсестры - 1
- ординаторская - 1
- палат на 1-го пациента - 3
- палат на 2-х пациентов - 6
- палат на 4-х пациентов - 5

Все палаты, рассчитанные на 2-х пациентов имеют туалетные комнаты. Палаты, рассчитанные на 1-го пациента, помимо туалетов, имеют еще и душевые комнаты. В коридоре терапевтического отделения располагаются отдельно стоящие (вне палат) туалетная и душевая комнаты. Для всех палат необходимо предусмотреть систему вызова персонала с разговорным трактом. Необходимо предусмотреть разговорный тракт между постом медсестры и ординаторской, а также между постом медсестры и входной дверью в отделение (с возможностью контроля доступа в отделение). Во всех санузлах и душевых комнатах отделения предусмотреть установку влагозащищенных кнопок экстренного вызова.

**Обоснование применяемого оборудования**

Настоящим проектным решением предусмотрена установка специализированной системы палатной сигнализации "HostCall-CMP" с разговорным трактом производства компании ООО "СКБ Телси" (Россия). Система вызова персонала серии «HostCall-CMP» относится к классу специализированных систем диспетчерской связи и сигнализации, и является профессиональной системой палатной сигнализации и связи для отделения стационара больницы или аналогичного медицинского учреждения. Система вызова персонала серии «HostCall-CMP», имея широкие функциональные возможности, упрощает процесс взаимодействия медицинского персонала отделения и пациентов, что позволяет персоналу отделения повысить эффективность своей работы.

Перв. примен.
Справ. N

Погн. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N
Погн. и дата
Инв. N подл.

Изм.	Лист	N докум.	Погн.	Дата	Система палатной сигнализации "HostCall-CMP" с разговорным трактом	Лист
						4

Перв. примен.	<p>Система палатной сигнализации и связи серии «HostCall-CMP» предназначена для обеспечения медицинским персоналом отделения надлежащего наблюдения и ухода за пациентами, предоставления пациентам комфортности и защищенности во время пребывания в больнице, а также повышения ответственности и эффективности работы самого персонала отделения. Система «HostCall-CMP» является цифровой системой и представляет собой аппаратно-программный комплекс, использующий в качестве магистральной среды передачи данных промышленный цифровой магистральный интерфейс RS-485, нашедший широкое применение в промышленности и, в частности, в системах автоматики и безопасности, и который хорошо известен и освоен монтажными организациями.</p> <p>Система палатной сигнализации и связи серии «HostCall-CMP» имеет экспертное заключение № 77.01.09.П002766.08.20 от 26.08.2020 г. о соответствии продукции санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Система палатной сигнализации и связи серии «HostCall-CMP» имеет декларации Евразийского экономического союза о соответствии требованиям ТР ТС 020 / 2011 "об электромагнитной совместимости технических средств" и о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 037 / 2016 "об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". Производитель системы палатной сигнализации и связи серии «HostCall-CMP» компания ООО СКБ "Телси" имеет сертификат "Менеджмента качества" ISO 9001:2015 и сертификат "Системы менеджмента качества медицинских изделий" ISO 13485:2016. Все оборудование палатной сигнализации и связи серии «HostCall» производится на территории Российской Федерации.</p> <p>Высокий уровень технической поддержки, эксплуатационной документации и информационной поддержки на специализированном сайте способствует простоте монтажа и эксплуатации системы. Конструкторские решения, применяемые при производстве контроллеров, пультов и других компонент системы отличаются привлекательностью с точки зрения удобства монтажа, современностью дизайна и высоким уровнем эргономики.</p> <p>Система «HostCall-CMP» обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выполнение всех основных функций предъявляемых в настоящее время к системам вызова персонала и имеющихся в импортных аналогах;</li> <li>• возможность гибкого конфигурирования и расширения;</li> <li>• высокую надежность благодаря использованию технологии поверхностного (SMD-компонентов) монтажа;</li> <li>• простоту в использовании пациентами и персоналом;</li> <li>• наилучшее соотношение цена/качество.</li> </ul> <p><b><u>Исходные данные для оснащения входа в отделение световыми маяками:</u></b></p> <p>В соответствии с «СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.» необходимо оснастить вход и выход из отделения средствами информирования и ориентирования и расположении дверного проема для маломобильных групп населения и инвалидов. Для этого необходимо смонтировать световые маяки MP-700W1 с двух сторон от дверного проема как на входе, так и на выходе из отделения.</p> <p><b><u>Основные проектные решения по палатной сигнализации:</u></b></p> <p>На специально выделенном компьютере (сервере) под управлением ОС не ниже версии Windows 10Prof или Windows Server устанавливается программа «HostCall-Nurse-Statistics». Программное обеспечение HostCall-Nurse, используемое в системе палатной сигнализации, внесено в единый реестр Российских программ для электронных вычислительных машин за номером 4778 и рекомендовано для госзакупок. Программа позволяет работать со всеми отделениями больницы, в которых установлена палатная сигнализация HostCall-CMP. Программа работает по локальной сети больницы с преобразователями интерфейсов MP-251W4. На каждое отделение устанавливается один MP-251W4. Также программа осуществляет сбор статистики вызовов пациентов из палат со всех отделений больницы, в функционал программы заложена работа со смартфонами с операционной системой Android и установленной программой «HostCall-Nurse-M». В ПО «HostCall-Nurse-Statistics» можно выбрать на какие смартфоны какие вызовы поступают, и от каких отделений. Для бесперебойной работы смартфонов в больнице необходимо организовать бесшовную WI-FI сеть. На основном посту дежурной медсестры (помещение 1) устанавливаются табло отображения MP-761WA, пульт персонала с разговорным трактом MP-121D2 и телефонная трубка MP-511T2, работающая только на прием вызовов от пациентов, ординаторской и от входной двери. Если техническим заданием оговорено, что медсестра сама может инициировать переговоры с пациентами и ординаторской, то в место телефонной трубки необходимо установить телефонный аппарат. При использовании радиотелефона DECT с функцией определителя номера – медсестра сможет принимать и совершать вызовы на всей территории покрытия DECT, и на дисплее телефона будет отображаться кто ее вызывает. Табло MP-761WA отображает все поступающие вызовы, а также присутствие персонала в палате.</p>				
Справ. N					
Погн. и дата					
Инв. N субл.					
Взам. инв. N					
Погн. и дата					
Инв. N подл.					
Изм.	Лист	N докум.	Погн.	Дата	<p style="text-align: center;"><i>Система палатной сигнализации "HostCall-CMP" с разговорным трактом</i></p> <p style="text-align: right;">Лист 5</p>



Перв. примен.	<p><u>Индикация вызовов в коридоре:</u></p> <p>Табло отображения MP-761WA может быть установлено в коридоре или другом удобном для персонала месте. На табло отображения MP-761WA имеется визуальная и звуковая индикация вызовов, поступающих из палат. Оно отображает в бегущей строке в текстовом режиме текущие вызовы (тип вызова отображается соответствующим цветом), при этом идентификация осуществляется с точностью до пациента (кнопки вызова). Индикация вызова на табло снимается вместе со снятием вызова от пациента (например, нажатием на кнопку присутствия/ сброса в соответствующей палате или с основного пульта, после окончания переговоров). Также имеется возможность временного отключения звукового сигнала с помощью кнопки на лицевой панели или носимой радиокнопки. В отсутствие вызовов табло работает в режиме часов - на нем отображается текущее время и дата. Табло подключается к интерфейсу RS-485 отделения и к блоку питания БП-1А.</p> <p>При поступлении вызовов на табло в верхней строке отображается их количество, а в 4-х нижних строках отображаются текстовые надписи в формате «Название точки вызова - Название нажатой кнопки», которые задаются и вносятся в память табло (программируются) пользователем при монтаже системы с помощью специальной программы. В случае если в системе имеется более 4-х вызовов одновременно, отображаемые вызовы сдвигаются вверх, и движутся циклически. Перед каждой строкой отображается порядковый номер вызова.</p> <p>При поступлении более 10 вызовов нумерация переходит из цифровой в буквенную, т.е. 1,2,3...9,А,Б,В... Обычные вызовы и вызовы из санузлов отображаются красным цветом, вызов «Врача» в палату отображается синим цветом, «Присутствие персонала» - зеленым.</p> <p>Установленные в коридоре отделения над дверьми палат коридорные лампы MP-611W1 подключаются к палатным консолям MP-331W1 и отображают следующие вызовы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• стандартный вызов - постоянное свечение красным цветом;</li> <li>• вызов из санузла - прерывистое свечение красным цветом;</li> <li>• вызов врача - прерывистое свечение синим цветом;</li> <li>• присутствие персонала в палате - прерывистое свечение зеленым цветом.</li> </ul>					
	Справ. N	<p><u>Вызов врача:</u></p> <p>Вызов врача осуществляется, как правило, на дополнительный пульт или табло, установленные в помещении дежурного врача или ординаторской. А так же дублируются на смартфон. Данный пульт или табло настраивается для отображения только вызовов врача и присутствия персонала. Остальные вызовы от пациентов игнорируются. Кнопка вызова врача располагается в корпусе палатной консоли MP-331W1, которая устанавливается внутри палаты, рядом с входной дверью.</p> <p>В системе предусмотрен прием и индикация вызовов врача:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• На табло отображения MP-761WA, установленные на посту медсестры, в ординаторской и коридоре;</li> <li>• На коридорных лампах MP-611W1;</li> <li>• На смартфонах и сотовых телефонах медицинских сотрудников.</li> </ul> <p>Табло отображения MP-761WA может устанавливаться в режим, когда оно будет отображать только вызовы врача и в таком режиме оно используется для установки в ординаторской. При вызове врача на мониторе пульта MP-121D2 выводится надпись "Вызов врач". Установленная в коридоре отделения над дверью каждой палаты коридорная лампа MP-611W1 отображает вызовы врача прерывистым свечением синего цвета. На табло отображения MP-761WA, установленном в ординаторской, в бегущей строке синим цветом отображается соответствующая запись с указанием номера палаты, из которой поступил вызов. Вызов сопровождается звуковым сигналом. Табло отображения MP-761WA может быть установлено также в коридоре или другом удобном для персонала месте. На нем имеется визуальная и звуковая индикация вызовов, поступающих из палат. Оно отображает в бегущей строке в текстовом режиме текущие вызовы, при этом идентификация осуществляется с точностью до пациента (кнопки вызова). Обычные вызовы и вызовы из санузлов отображаются красным цветом, вызов «Врача» в палату отображается синим цветом, «Присутствие персонала» – зеленым.</p>				
Погр. и дата		Инд. N дубл.	Взам. инв. N	Погр. и дата	Инд. N подл.	<p style="text-align: center;"><i>Система палатной сигнализации "HostCall-CMP" с разговорным трактом</i></p>
Изм.	Лист					

**Рекомендации по прокладке кабеля:**

Монтаж линий связи системы должен производиться в соответствии с нижеуказанными требованиями

Для связи палатных консолей MP-331W1 и проводных цифровых кнопок вызова рекомендуется применять кабель типа UTP 2x0,5. Допустимая длина кабеля не более 100 м.

Для организации разговорного тракта и связи палатных консолей MP-331W1 и переговорных устройств MP-522W1 рекомендуется применять кабели UTP 2x0,5. Во избежание помех в разговорном тракте и RS-485, рекомендуется использовать два разных кабеля.

Для шины низковольтного питания палатных консолей MP-331W1 следует использовать электрический двухпроводный кабель ШВВП с сечением жилы не менее 1.5 мм<sup>2</sup>. При длине шины до 70 м допускается подключение на одну шину не более 12 устройств, включая контроллеры всех типов и дополнительные пульты без разговорного тракта. В случае необходимости использования более длинных шин питания необходимо подключать к шине дополнительный блок питания через каждые 70 м кабеля. Кабель низковольтного питания прокладывается по коридорам за подвесным потолком. Спуски кабеля для питания палатных консолей выполнить кабелем ШВВП 2x0.5 через распаячные коробки.

Для шины магистрального интерфейса рекомендуется применять кабели UTP 2x0,5. Общая длина линии магистрального интерфейса RS-485 без использования специальных повторителей- ретрансляторов не может превышать 1200 м. При этом предъявляются следующие требования к параметрам кабеля: сечение одной жилы кабеля должно быть не менее 0,2 мм<sup>2</sup> (диаметр жилы не менее 0,5 мм), а погонная ёмкость между проводами линий А и В интерфейса не должна превышать 60 пФ/м. Это даёт суммарное сопротивление одной жилы провода 340 Ом и суммарную ёмкость в 240 нФ. Интерфейс RS-485 подразумевает структуру сети типа «шина», не допускается создание сети с конфигурацией «звезда» или «дерево». К этому кабелю подсоединяются все устройства, работающие по интерфейсу RS-485: контроллеры, пульты с разговорным трактом и без разговорного тракта, дополнительные пульты без разговорного тракта, табло отображения. Подключение входящей и уходящей линий RS-485 должно осуществляться только на клеммах устройства, без дополнительных ответвлений, так как они вносят рассогласование и вызывают отражений и наложение сигнала, что приводит к неработоспособности системы. В общем случае оба наиболее удаленных конца кабеля (Zв=120 Ом) линии магистрального интерфейса RS-485 включают согласующие резисторы Rt по 120 Ом (0.25 Вт). В системе «HostCall-CMP» это решено следующим образом. При использовании преобразователя интерфейсов MP-251W4 (RS-485/USB) он устанавливается первым, но включение согласующего резистора 120 Ом на его входе не требуется, т.к. он подключен внутри самого преобразователя интерфейсов. При использовании пультов с разговорным трактом или без разговорного тракта они должны быть первыми в магистральном интерфейсе RS-485, т.к. в них уже установлены нагрузочные сопротивления 120 Ом. В этом случае в последней палатной консоли MP-331W1 необходимо подсоединить сопротивление 120 Ом путем включения имеющейся в устройстве перемычки. Если последним устройством, подключаемым к интерфейсу RS-485, является дополнительный пульт без разговорного тракта или табло отображения, то в нем также необходимо включить нагрузочное сопротивление 120 Ом. Если пульт без разговорного тракта или табло отображения устанавливается не на концах магистрального интерфейса RS-485, то в нем необходимо соответственно поставить переключатель или вынуть перемычку, обеспечивающие отключение нагрузочного сопротивления 120 Ом.

Не допускается прокладка сигнальных цепей магистрального интерфейса RS-485 и кабелей разговорного тракта в непосредственной близости от кабелей сетевого питания, а также рядом с другими источниками электромагнитных помех. Согласно требованиям ПУЭ «Ведомственные нормы технологического проектирования проводных средств связи. ВНТП 116-80» расстояние от кабелей связи до силовых цепей 220В должно быть не менее 500 мм. Не допускается прокладка в одной трубе силовых и сигнальных (разговорных) цепей без применения специальных мер защиты, например, экранирования сигнальных и разговорных цепей. В общем случае, заземление экрана осуществляется только с одной стороны линии.

Питание световых маяков MP-700W1 выполнять кабелем ШВВП 2x1,5.

**Электропитание**

Электроснабжение помещений для СВП необходимо выполнять по ПУЭ-2000, ВСН-59-88", а также с учетом ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 50839 и других нормативных документов. Электропитание оборудования системы вызова персонала «HostCall-CMP» выполнить через блок питания 12В/5А ББП-50 (исп. 2). Питание самого ББП-50 (исп. 2) осуществить от запроектированной сети переменного тока напряжением 220В, частотой 50Гц. Цепь питания ББП-50 (исп. 2) монтировать кабелем ВВГ 2x1,5 от основного электрощита с выделением в отдельную группу и установкой отдельного автомата. Последнее обеспечивается Заказчиком.

Перв. примен.	Справ. N	Погн. и дата	Инв. N дубл.	Взам. инв. N	Погн. и дата	Инв. N подл.	<i>Система палатной сигнализации "HostCall-CMP" с разговорным трактом</i>					Лист
							Изм.	Лист	N докум.	Погн.	Дата	8

Перв. примен.

Справ. №


Погн. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Погн. и дата

Инв. № подл.

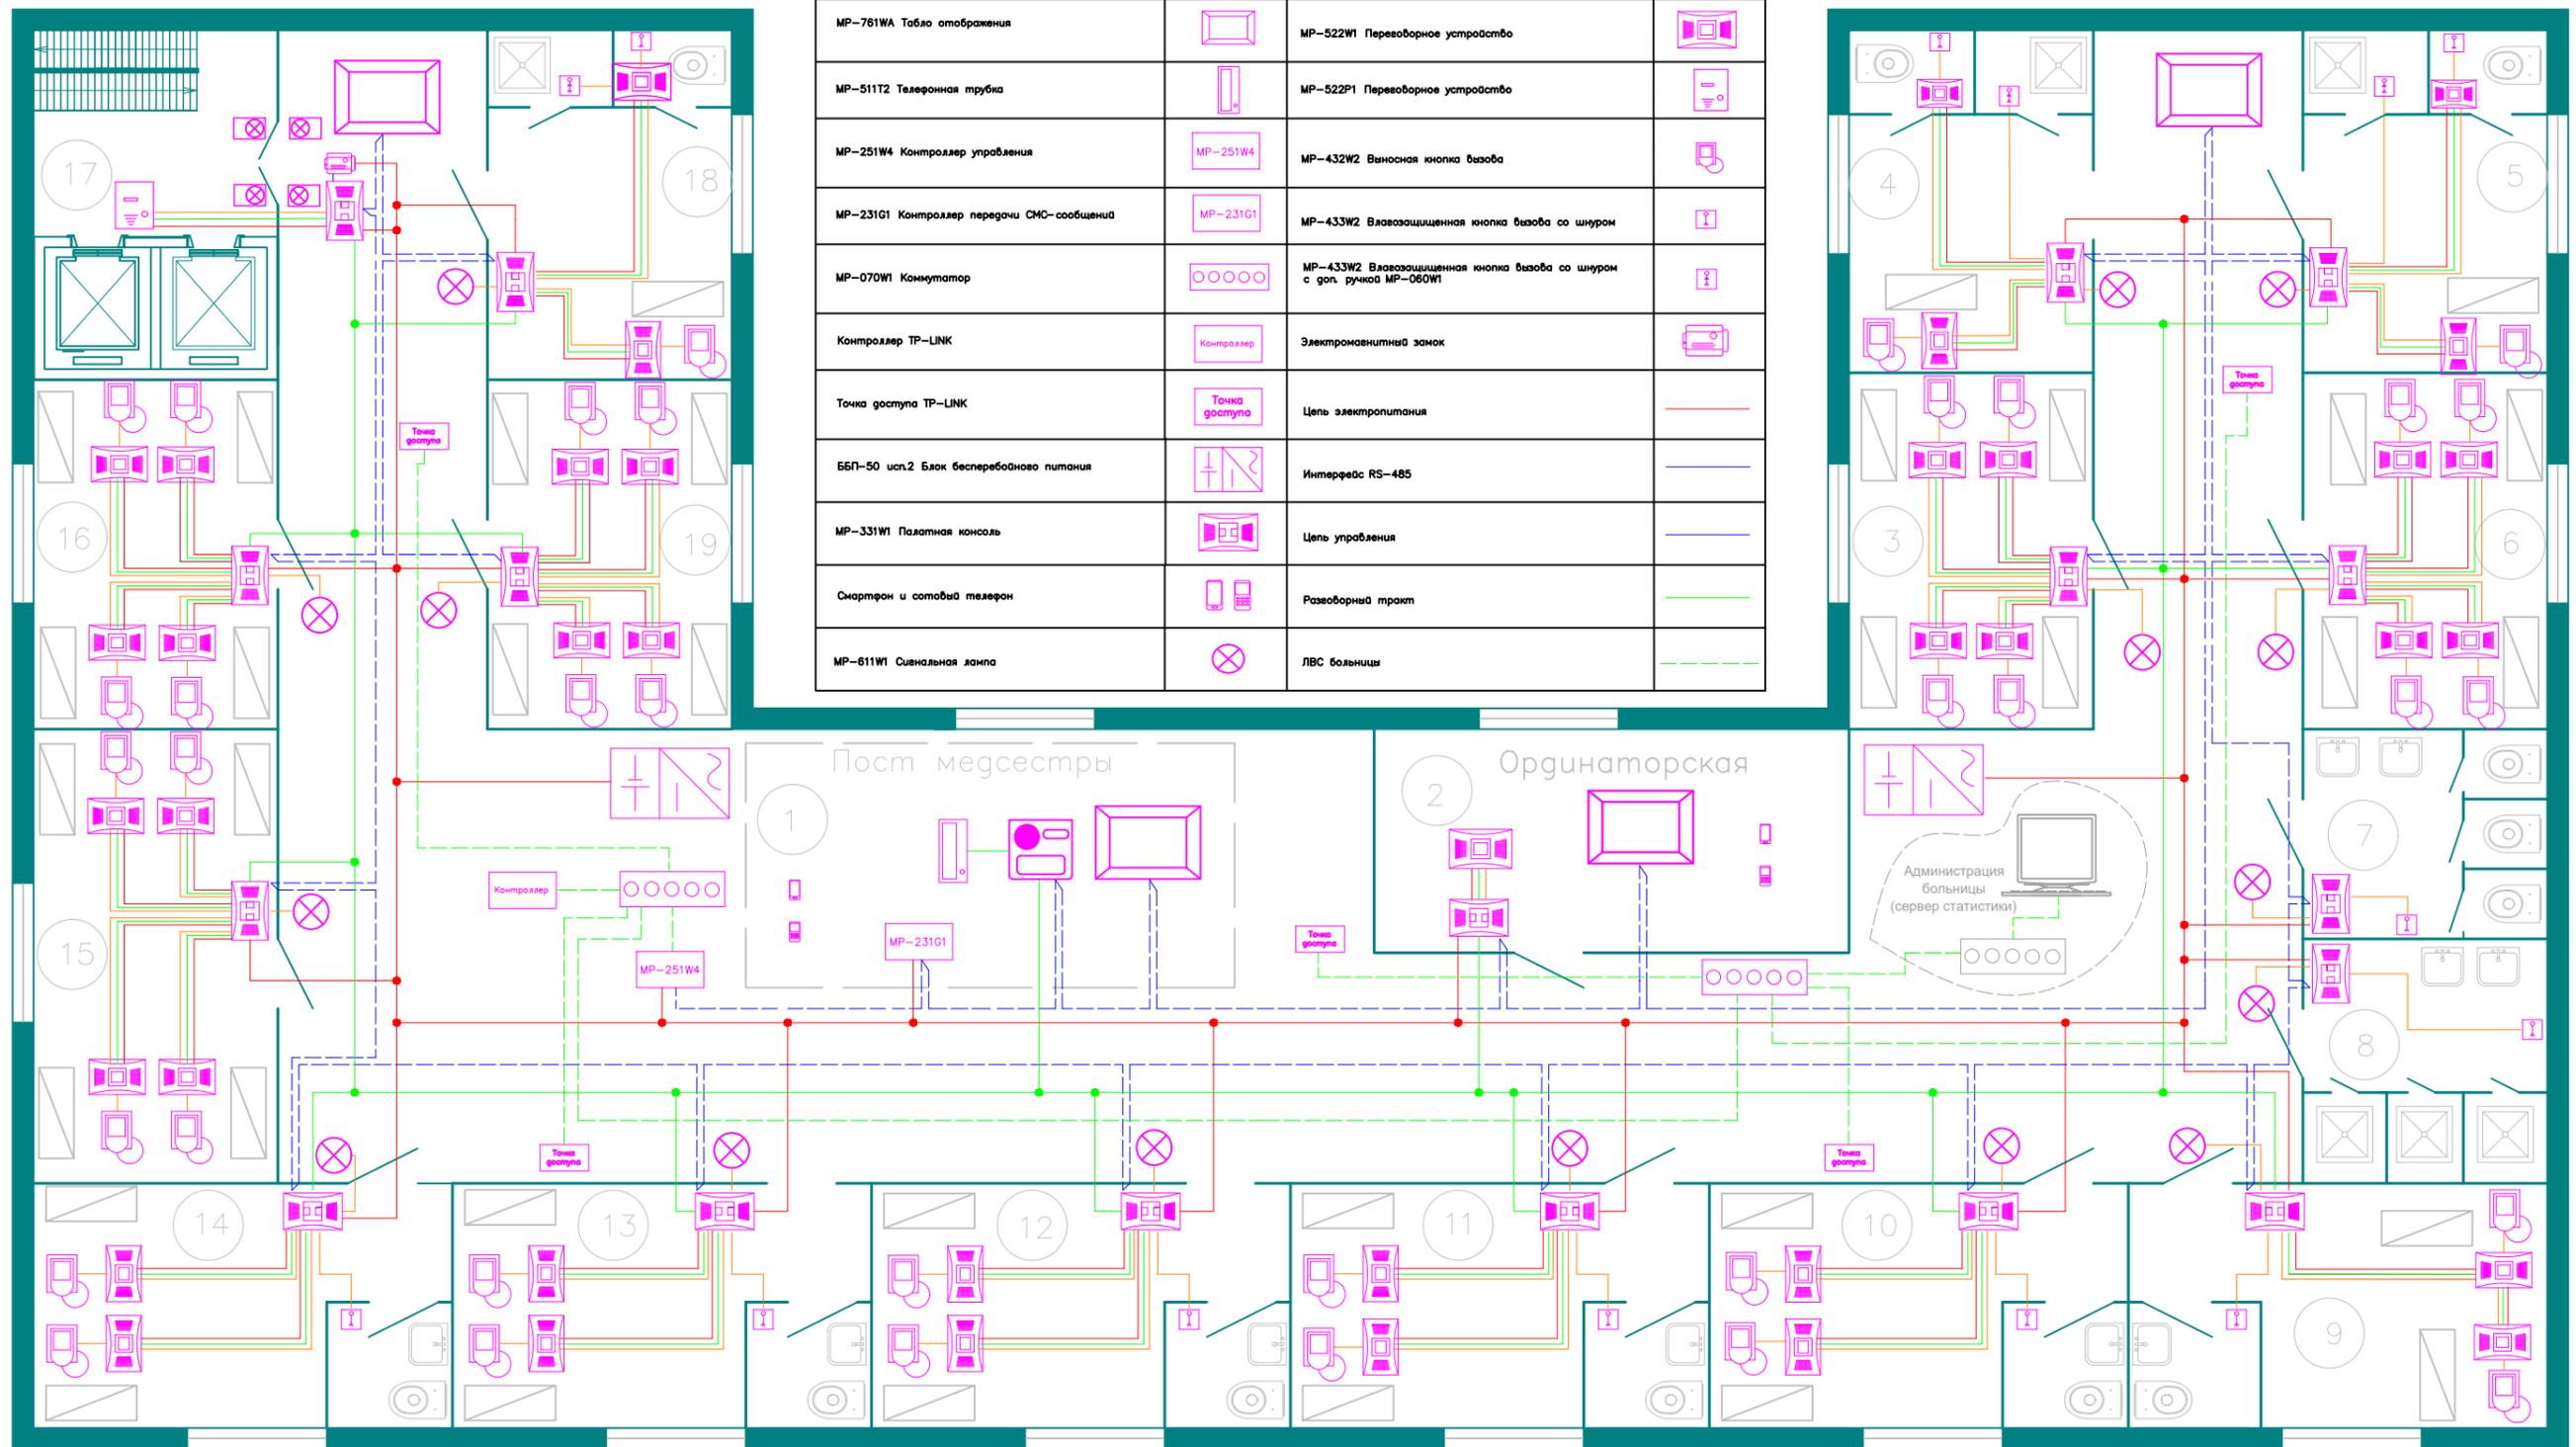


1	Пост медсестры	11	Палата на 2 койко-места с санузлом
2	Ординаторская	12	Палата на 2 койко-места с санузлом
3	Палата на 4 койко-места	13	Палата на 2 койко-места с санузлом
4	VIP-палата на 1 койко-место с сауном и душевой кабиной	14	Палата на 2 койко-места с санузлом
5	VIP-палата на 1 койко-место с сауном и душевой кабиной	15	Палата на 5 койко-мест
6	Палата на 4 койко-места	16	Палата на 4 койко-места
7	Санузел общий	17	Лестничный пролет
8	Душевая кабина общая	18	VIP-палата на 1 койко-место с сауном и душевой кабиной
9	Палата на 2 койко-места с санузлом	19	Палата на 4 койко-места
10	Палата на 2 койко-места с санузлом		

					Отделение кардиологии ЦРБ г. Озеры Московской обл.		
Изм.	Лист	№ докум.	Погн.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					Система палатной сигнализации "HostCall-CMP" с разговорным трактом		
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.					Лист 9	Листов	
Утв.					План расположения оборудования		

Копировал

Формат А3

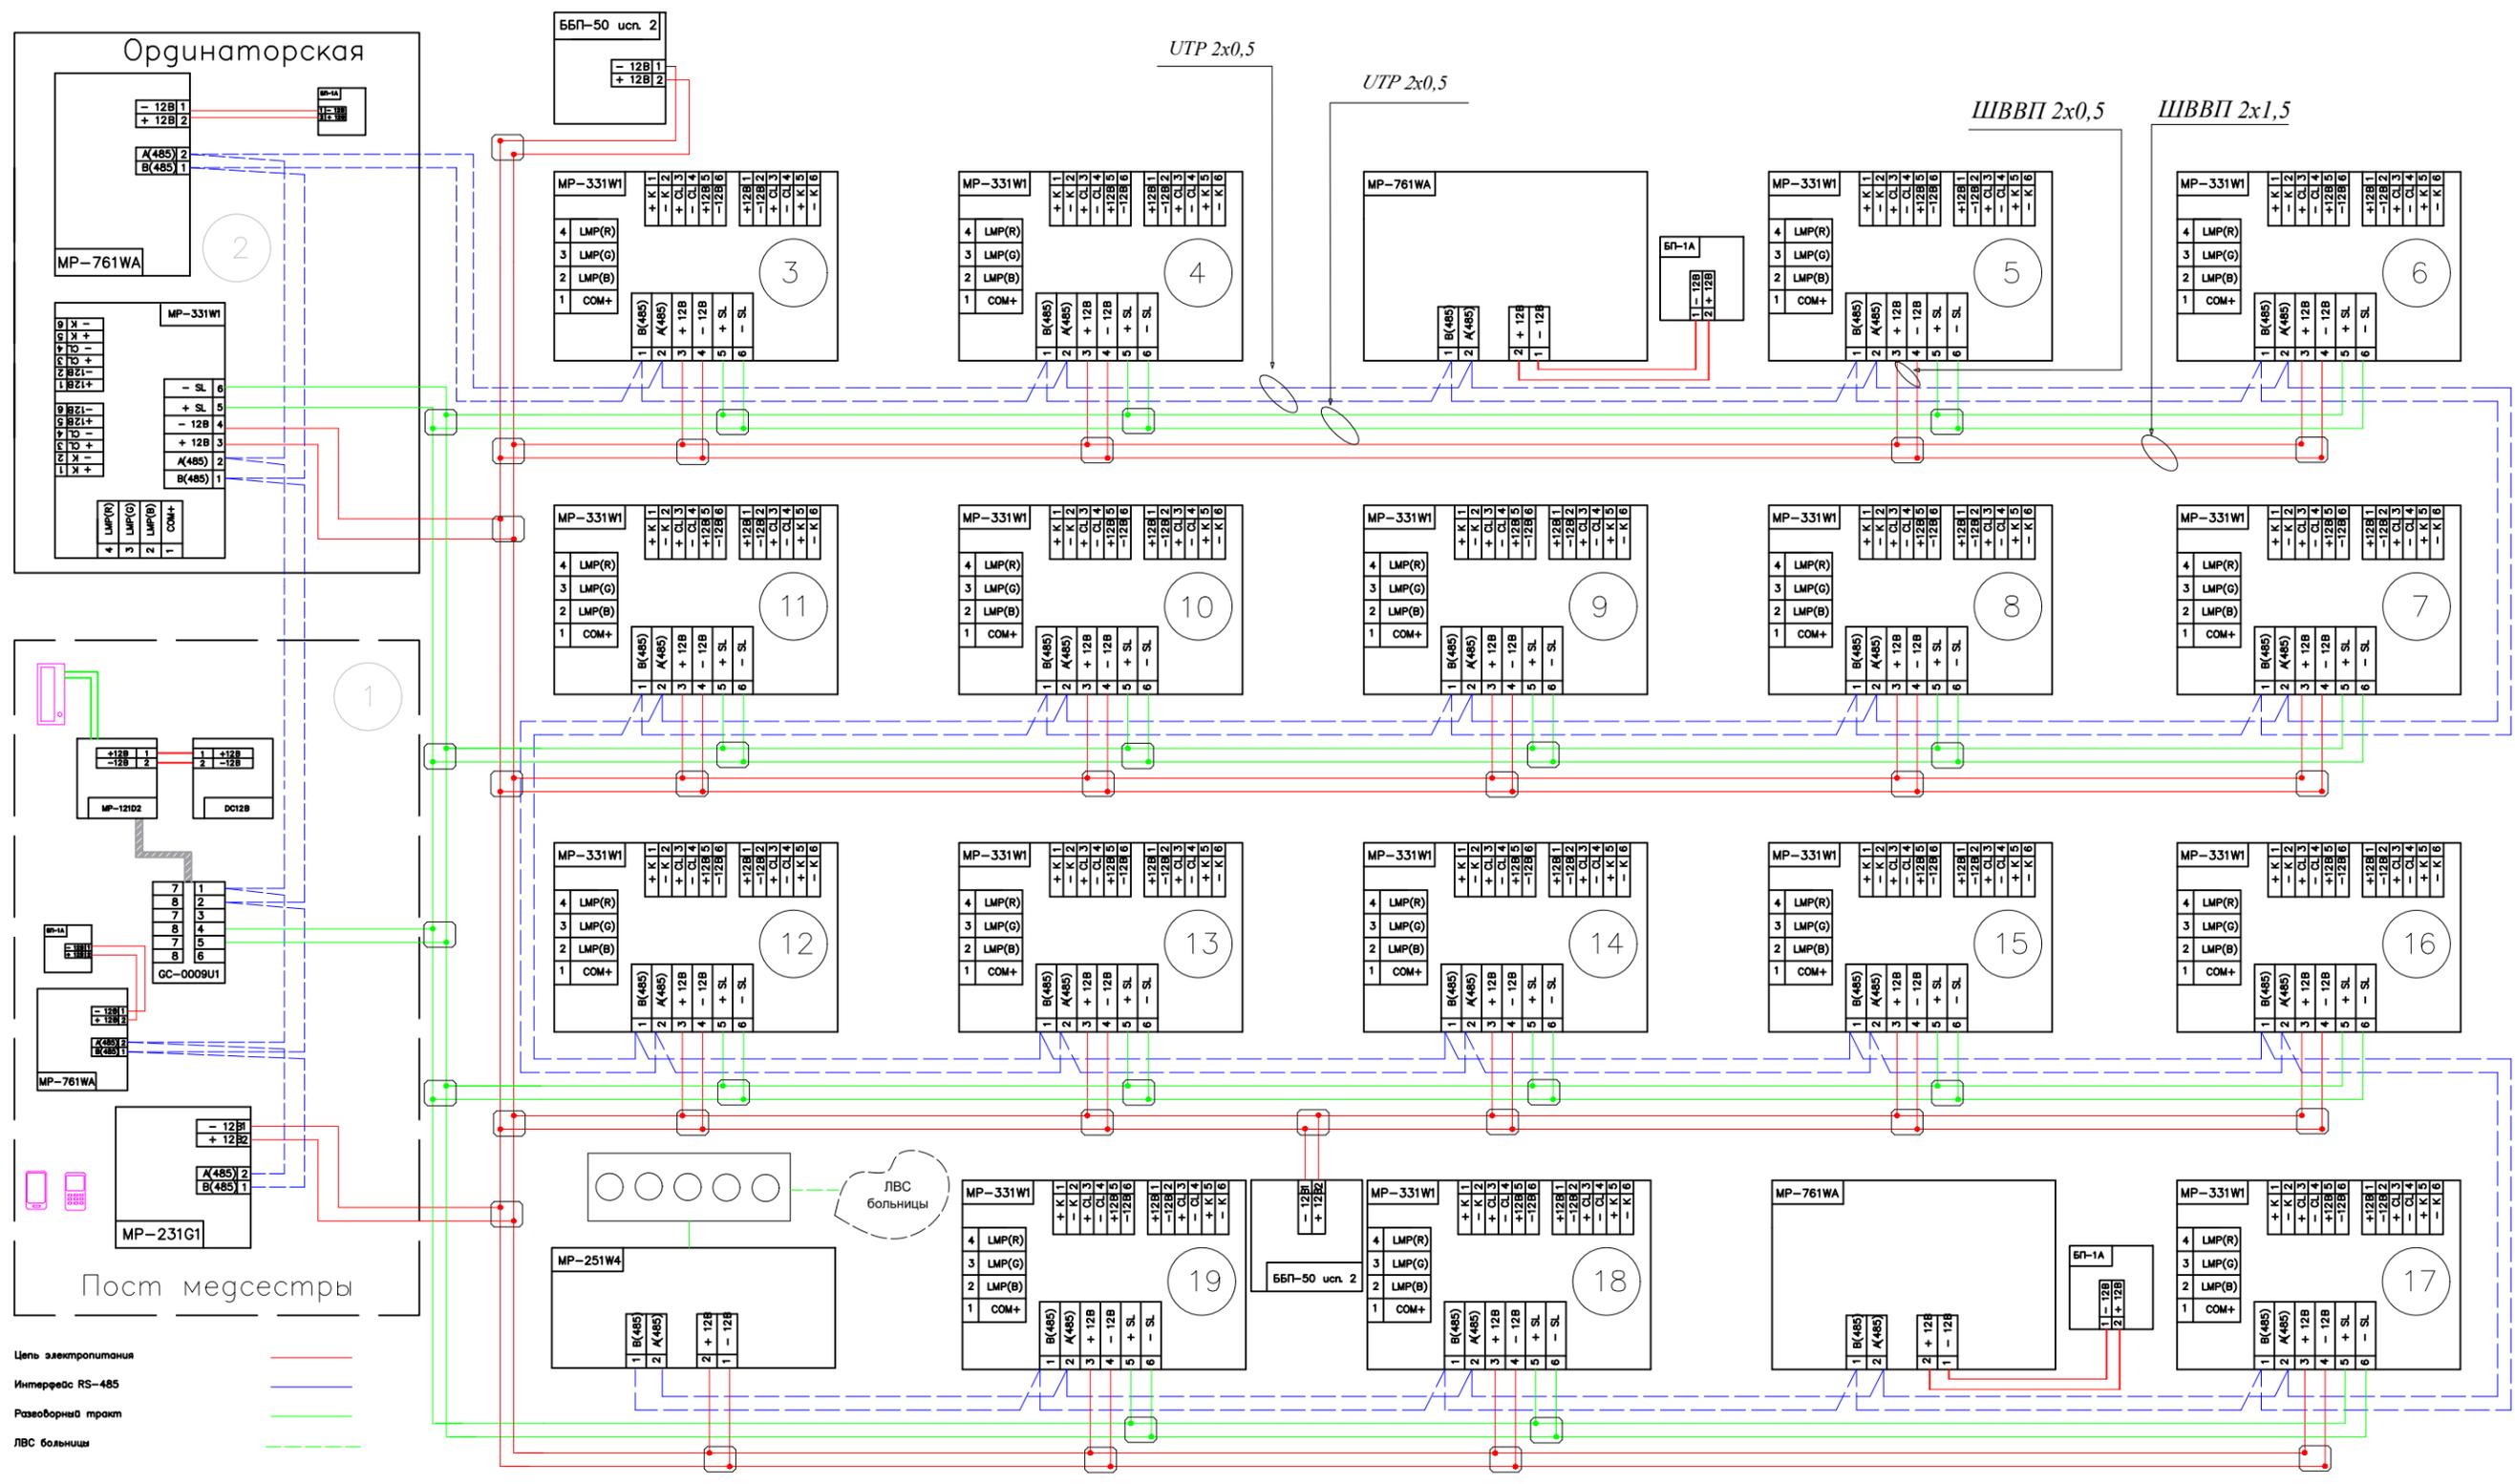

1	Пост медсестры	11	Палата на 2 койко-места с санузлом
2	Оргинаторская	12	Палата на 2 койко-места с санузлом
3	Палата на 4 койко-места	13	Палата на 2 койко-места с санузлом
4	MP-палата на 1 койко-место с сауном и душевой кабиной	14	Палата на 2 койко-места с санузлом
5	MP-палата на 1 койко-место с сауном и душевой кабиной	15	Палата на 5 койко-мест
6	Палата на 4 койко-места	16	Палата на 4 койко-места
7	Санузл общия	17	Лестничная пролет
8	Душевая кабина общия	18	MP-палата на 1 койко-место с сауном и душевой кабиной
9	Палата на 2 койко-места с санузлом	19	Палата на 4 койко-места
10	Палата на 2 койко-места с санузлом		

Изм.	Лист	№ докум.	Погн.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				


*Отделение кардиологии  
ЦРБ г. Озеры Московской обл.*

*Система палатной сигнализации  
"HostCall-CMP" с разговорным трактом*

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 10		Листов


*Структурная схема соединений  
отделения*

Перв. примен.	Справ. №	Погн. и дата	Инв. N дубл.	Взам. инв. №	Погн. и дата	Инв. № подл.
---------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

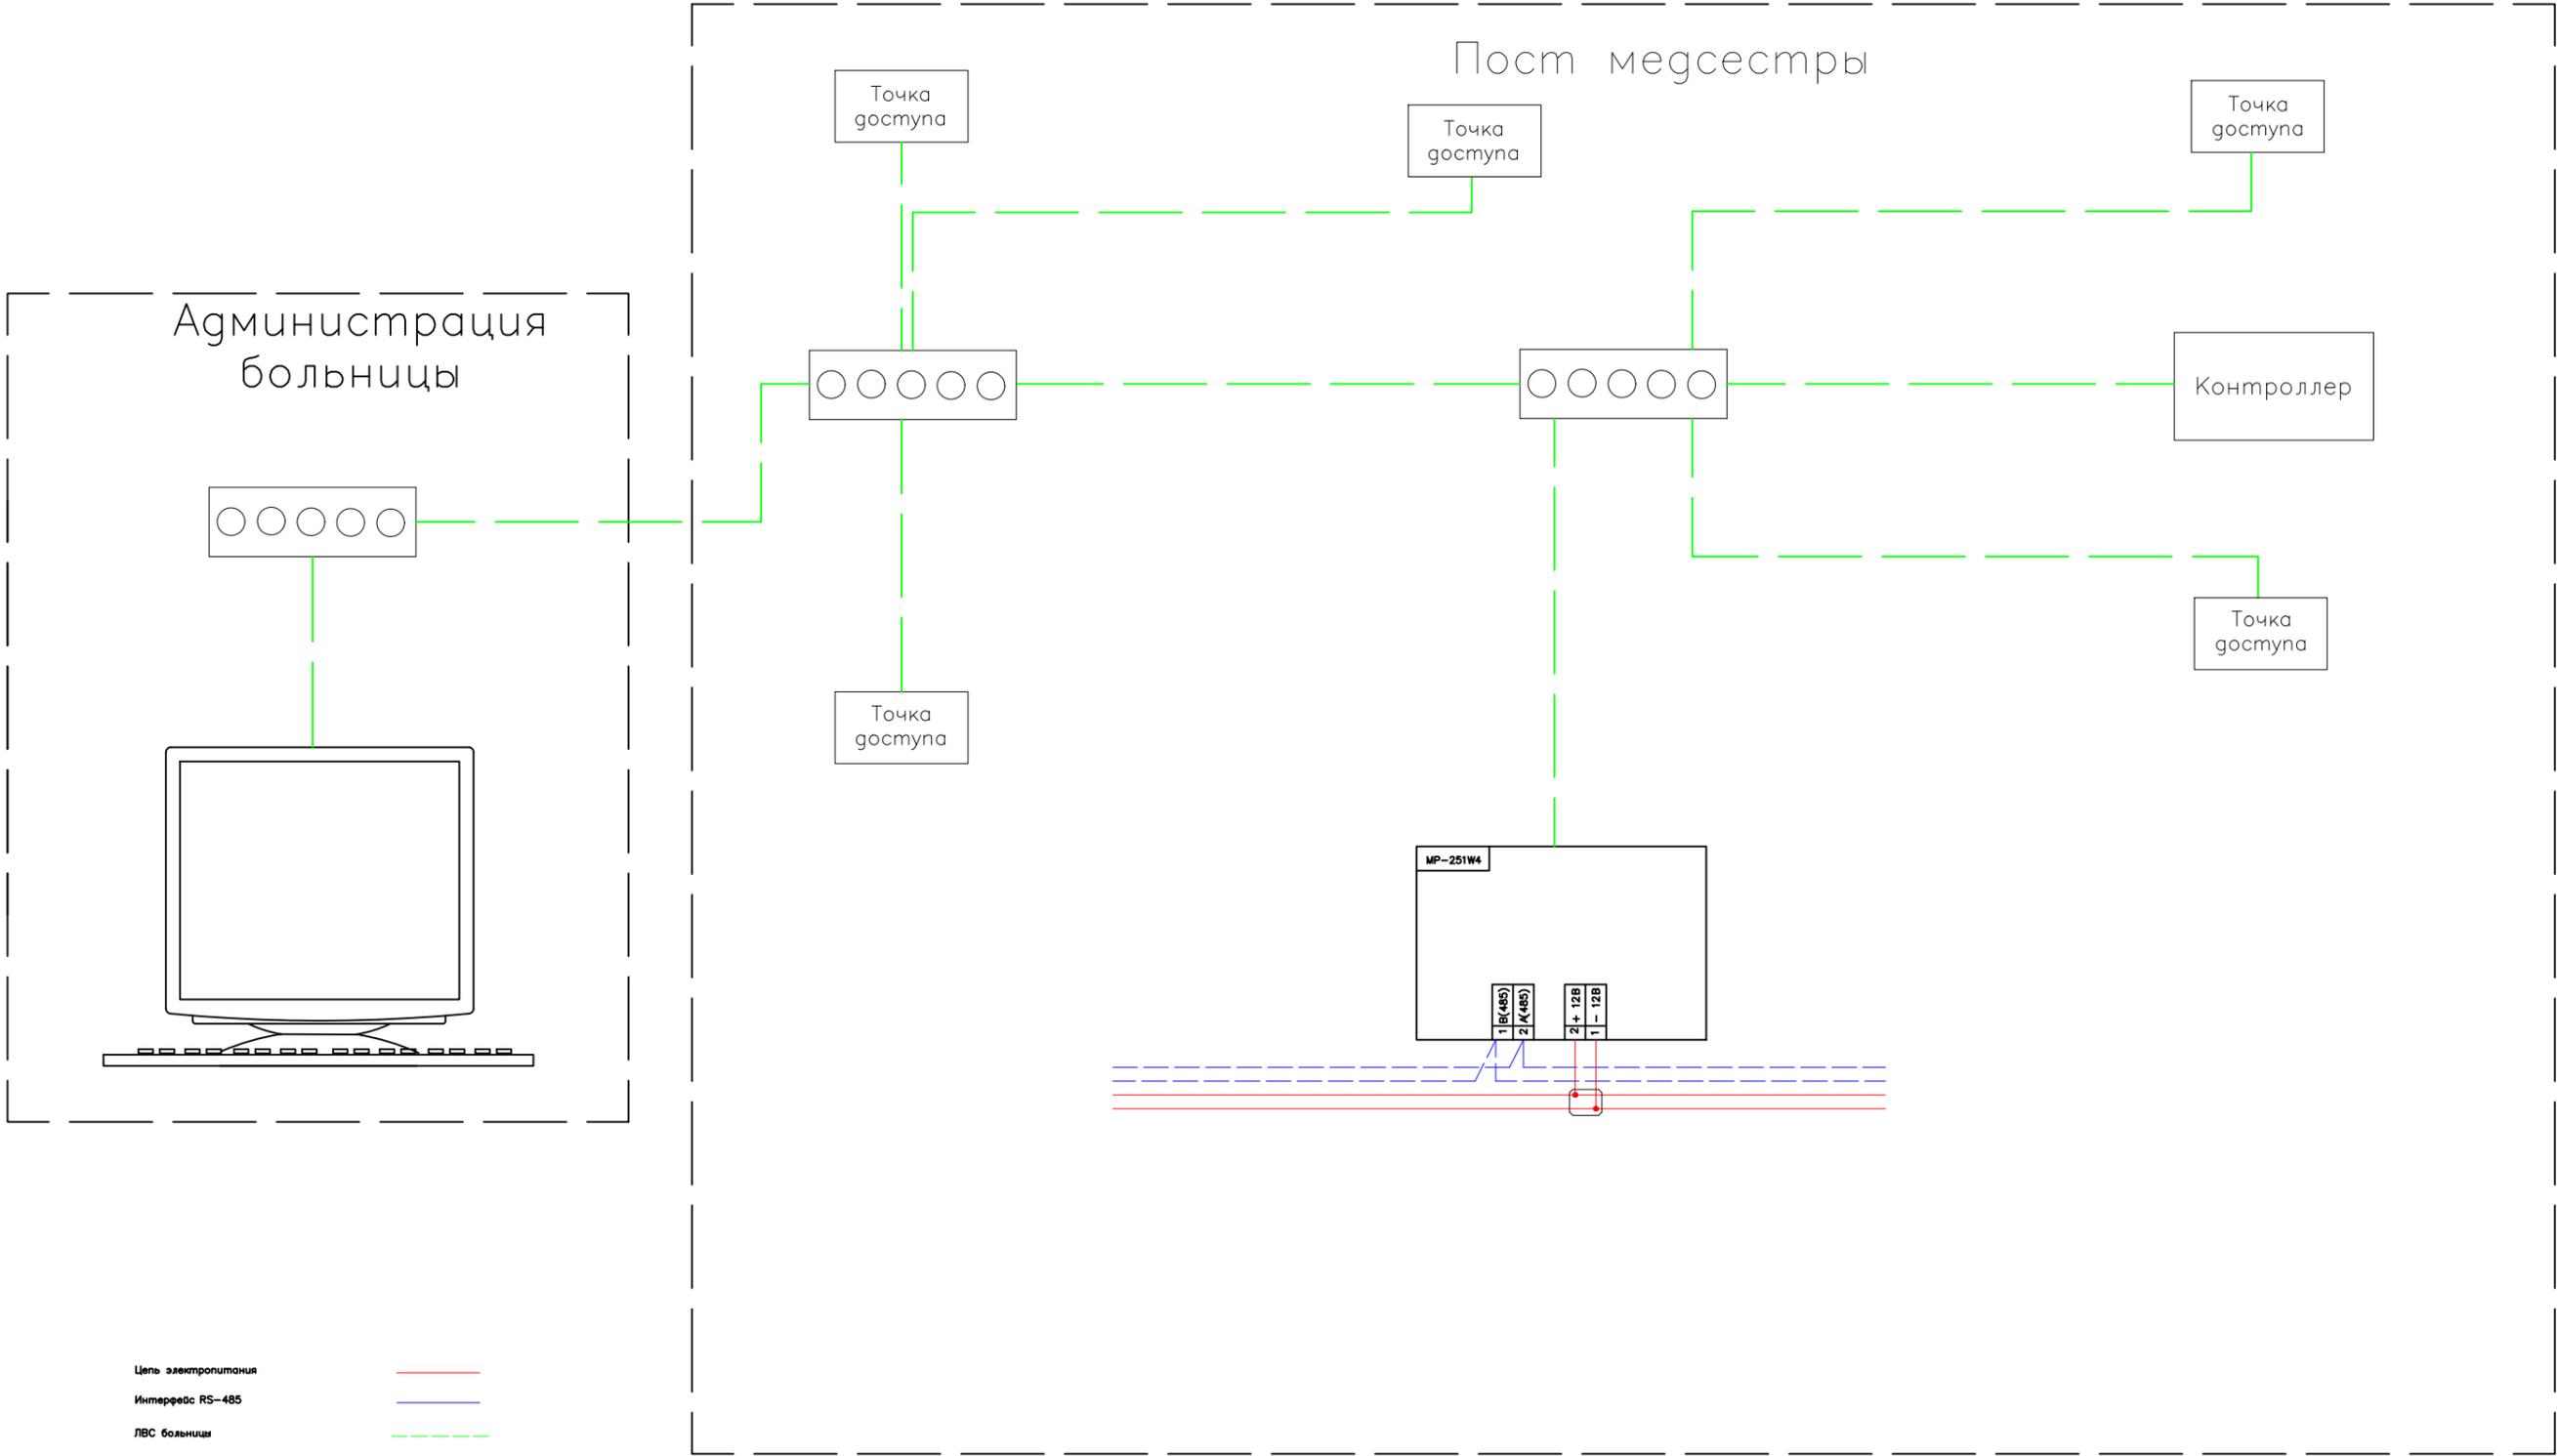

					<i>Отделение кардиологии ЦРБ г. Озеры Московской обл.</i>			
Изм	Лист	N° докум.	Погн.	Дата	<i>Система палатной сигнализации "HostCall-CMP" с разговорным трактом</i>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.						Лист 11	Листов	
Н.контр.					<i>ЛВС отделения и больницы</i>			
Утв.								


Перв. примен.	Справ. №	Погр. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Погр. и дата	Инв. № подл.
---------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

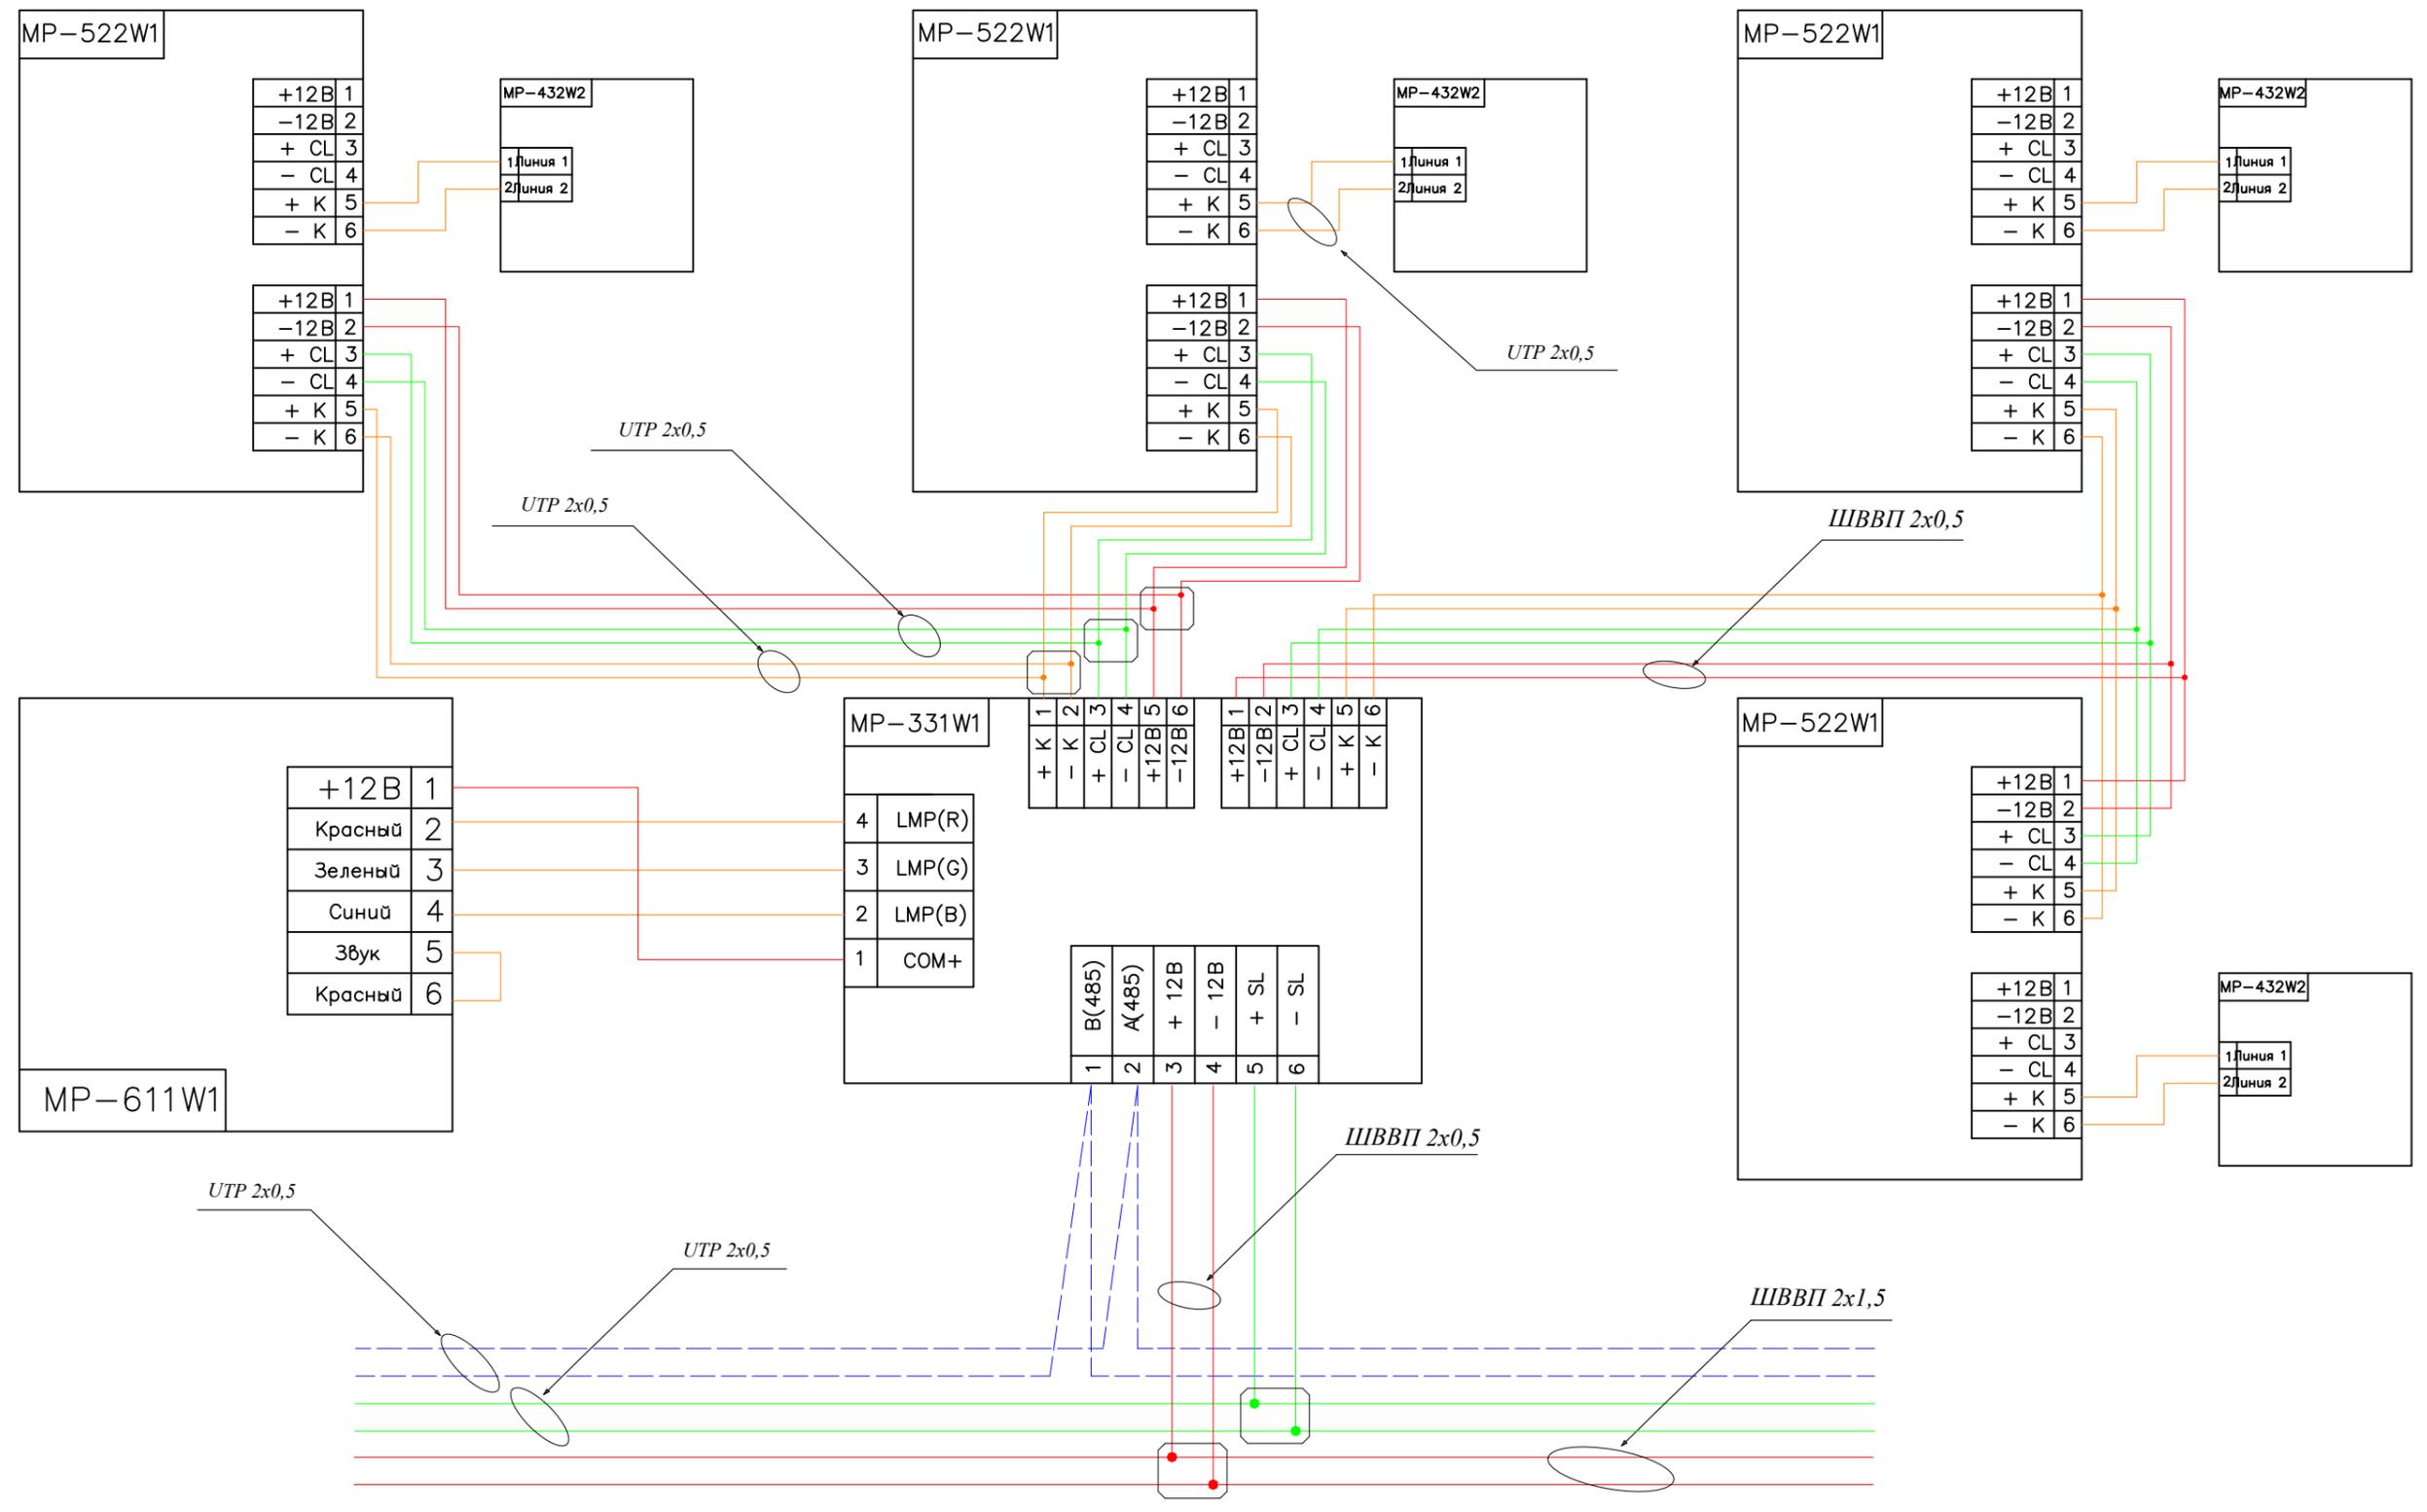

Цель электропитания — (red line)  
 Интерфейс RS-485 — (blue line)  
 Разборный тракт — (green line)  
 Силовая цель — (orange line)

					Отделение кардиологии ЦРБ г. Озеры Московской обл.			
Изм.	Лист	№ докум.	Погр.	Дата	Система палатной сигнализации "HostCall-CMP" с разговорным трактом	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.						Лист 12	Листов	
Н.контр.					Структурная схема соединений палата на 4 койко-места			
Утв.								

Перв. примен.
Справ. №
Погр. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Погр. и дата
Инв. № подл.

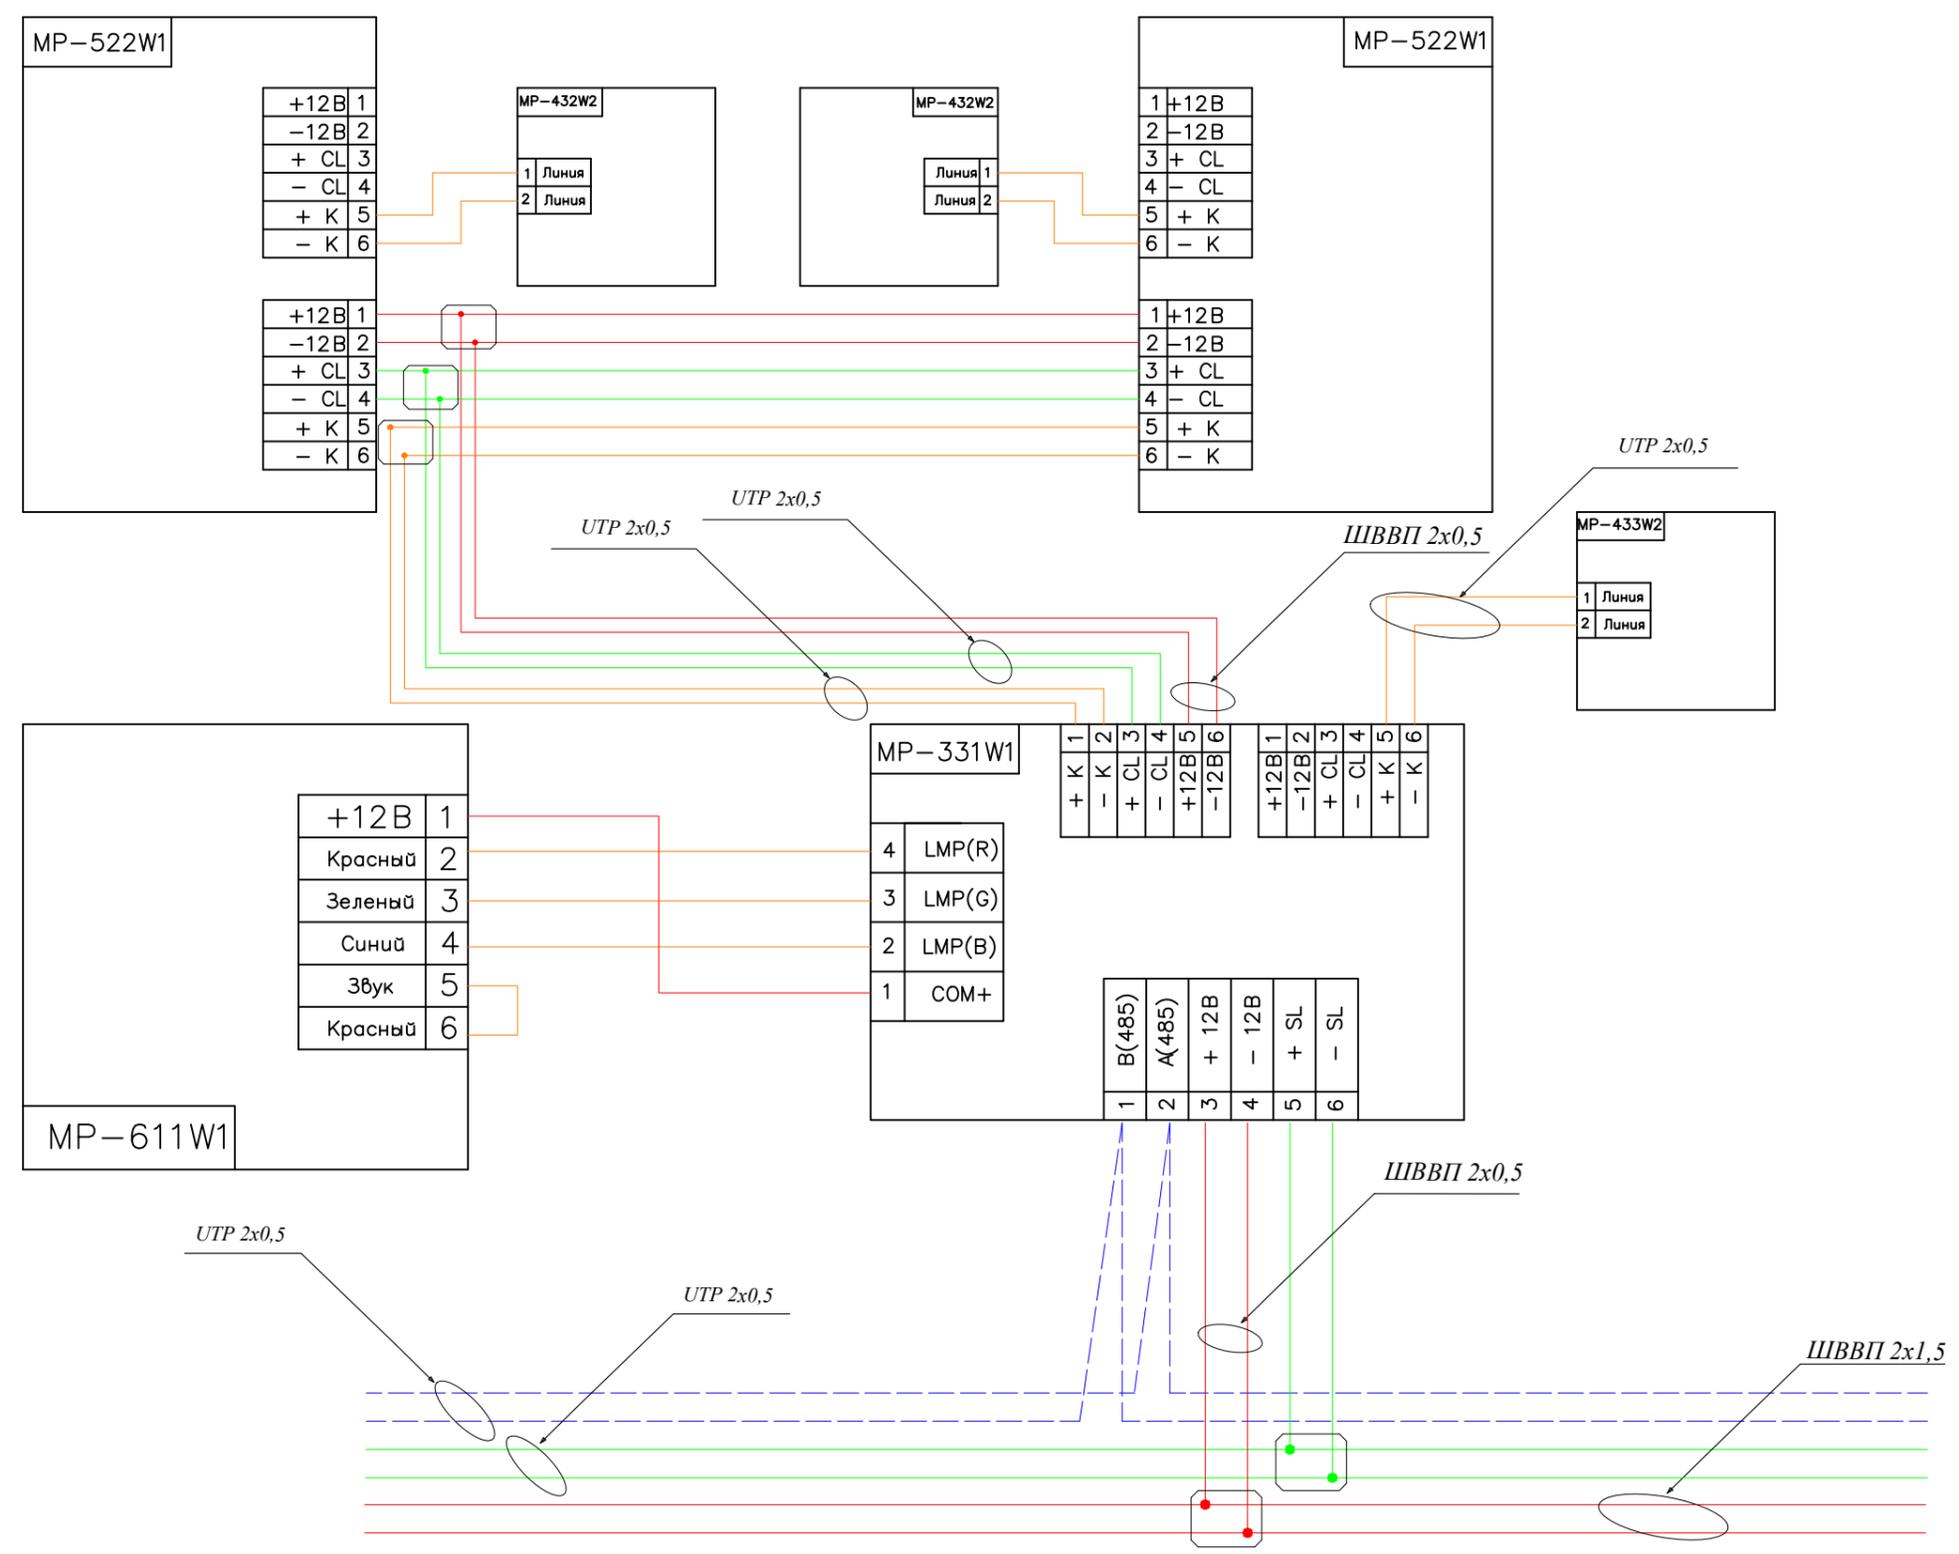


Цель электропитания  
Интерфейс RS-485  
Разговорный тракт  
Сигнальная цель








					Отделение кардиологии ЦРБ г. Озеры Московской обл.			
Изм.	Лист	№ докум.	Погр.	Дата	Система палатной сигнализации "HostCall-CMP" с разговорным трактом	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.						Лист 13	Листов	
Н.контр.					Структурная схема соединений палата 2 койко-места			
Утв.								

Инв. № подл.	Погр. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Погр. и дата	Справ. №	Перв. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------

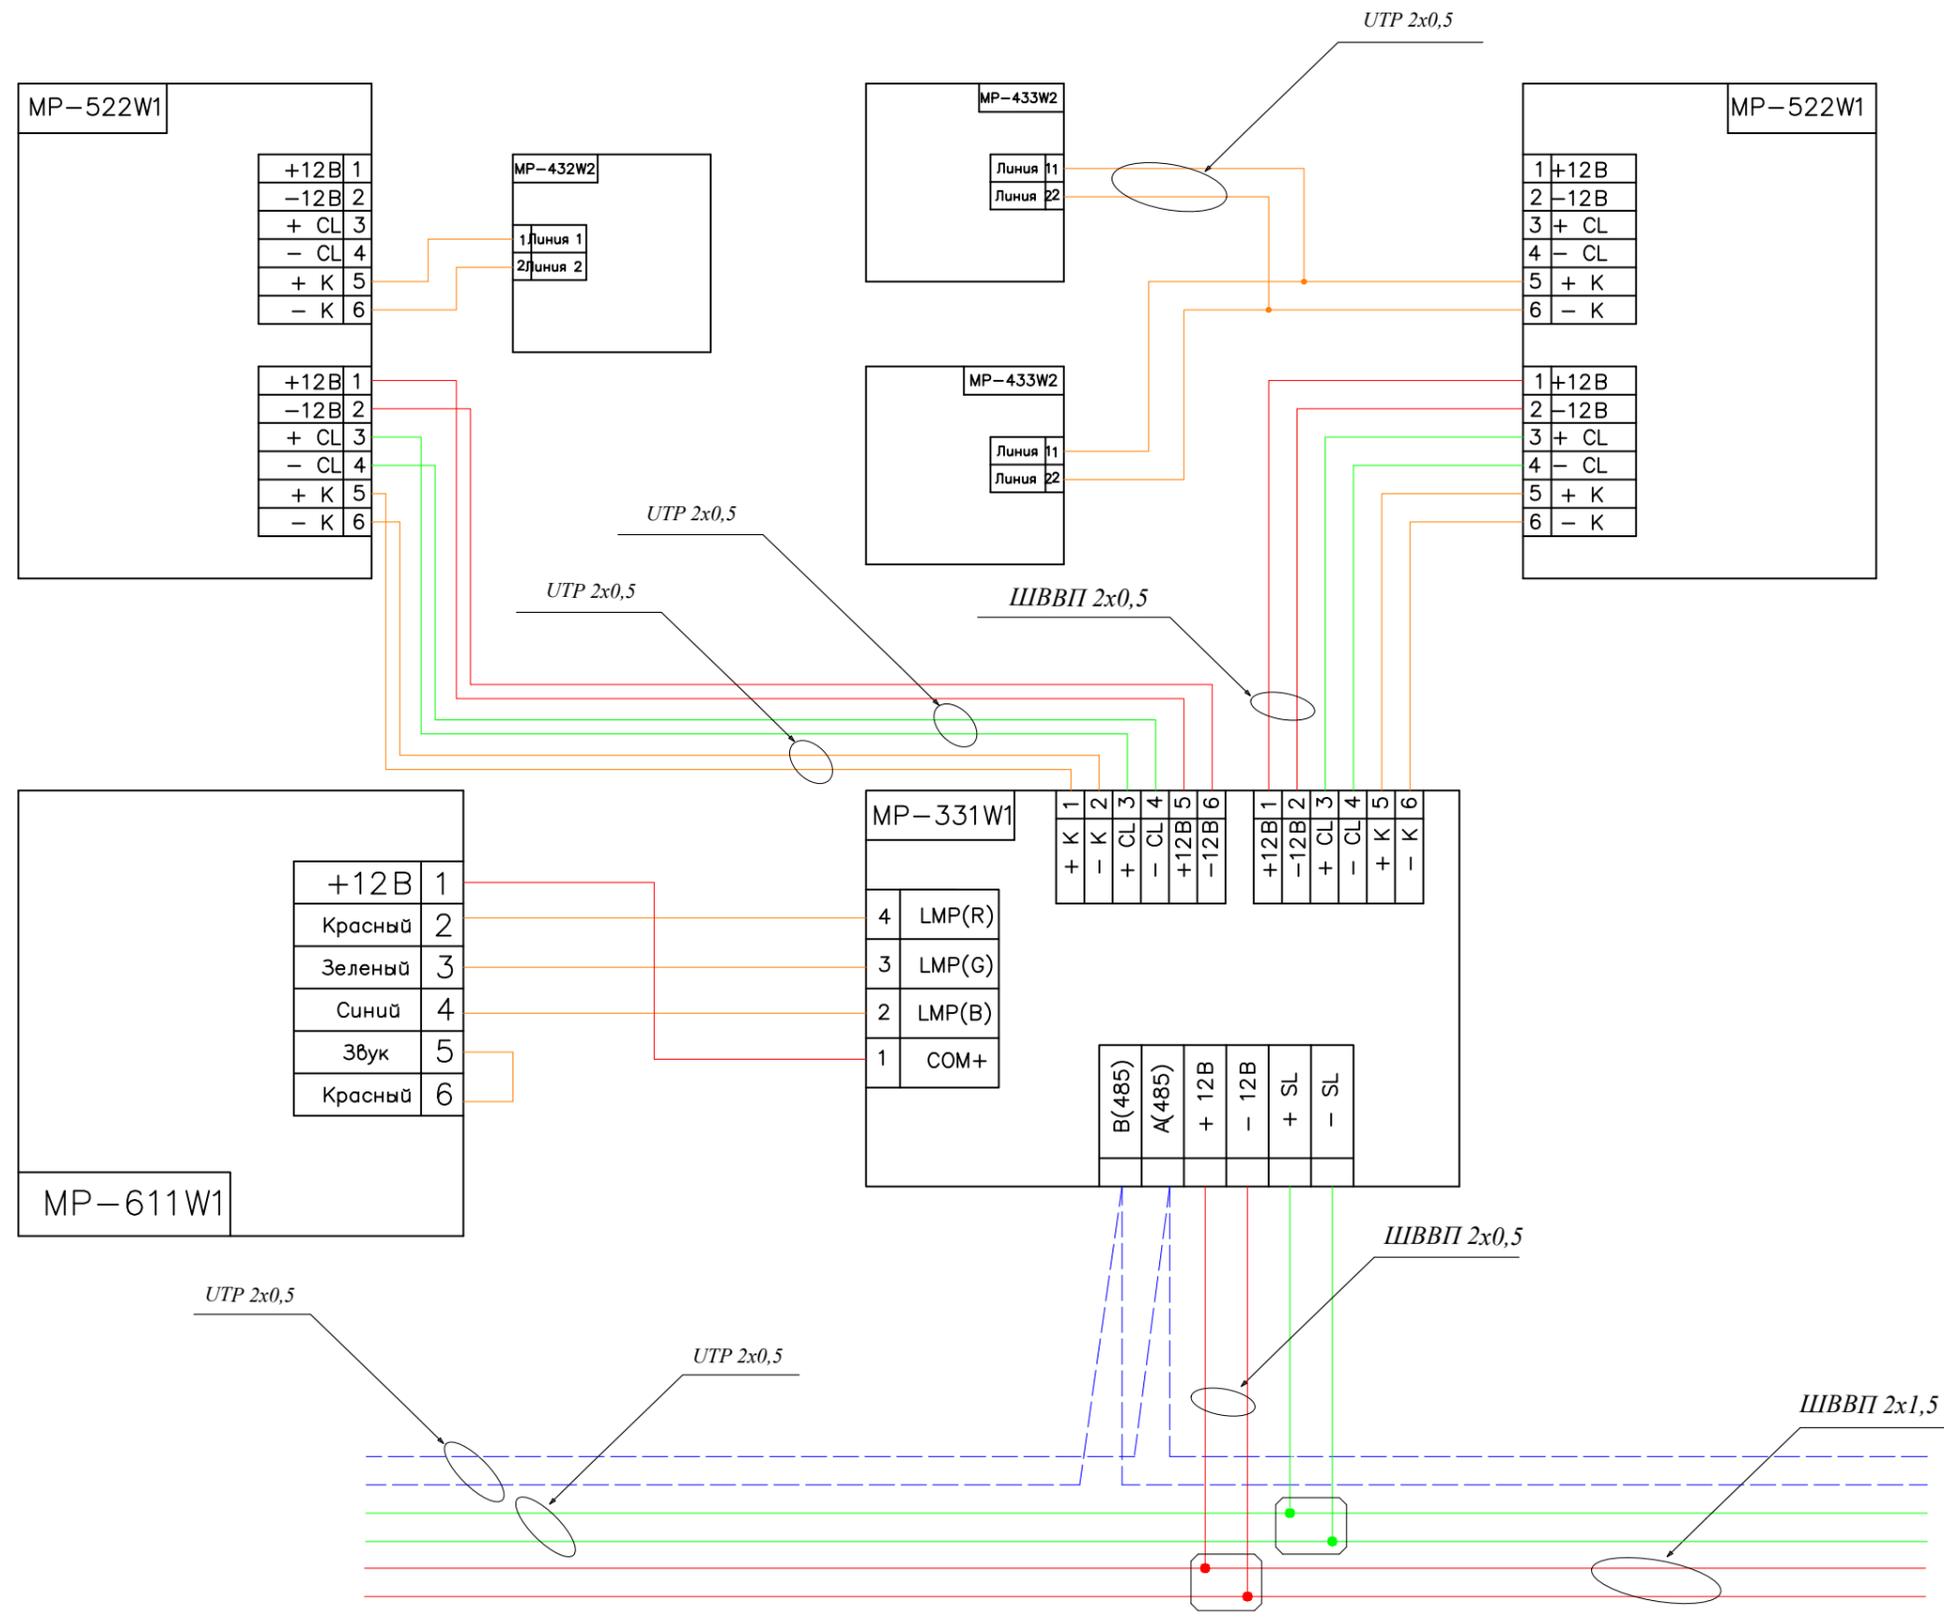


					Отделение кардиологии ЦРБ г. Озеры Московской обл.			
Изм.	Лист	№ докум.	Погр.	Дата	Система палатной сигнализации "HostCall-CMP" с разговорным трактом	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.						Лист 14	Листов	
Н.контр.					Структурная схема соединений VIP-палаты на 1 койко-место			
Утв.								

Инд. № подл.	Погр. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Погр. и дата	Справ. №	Перв. примен.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	---------------

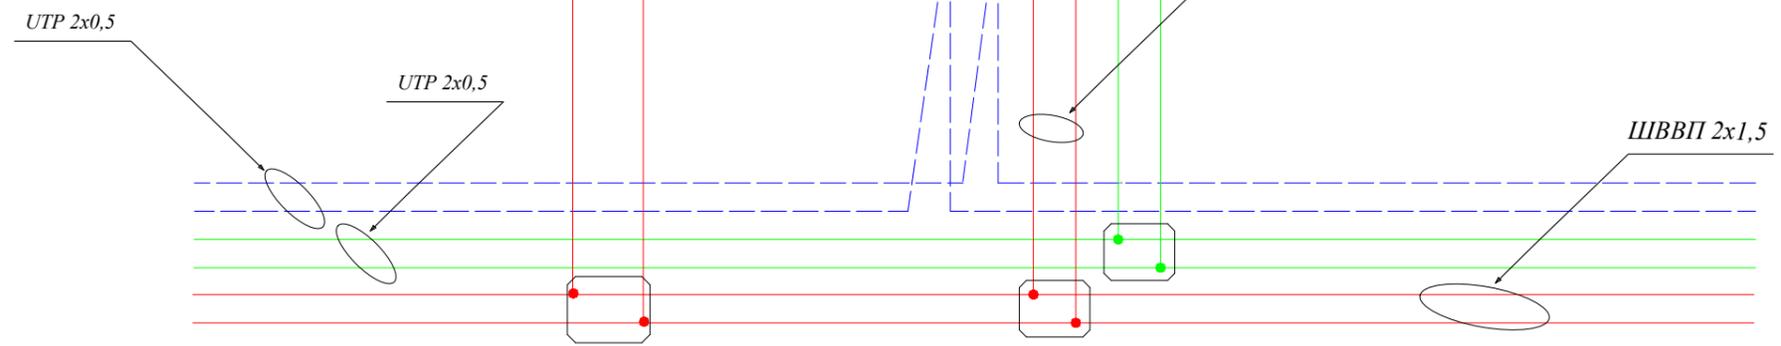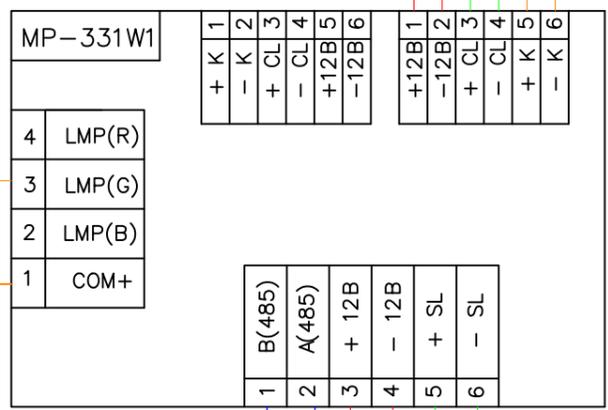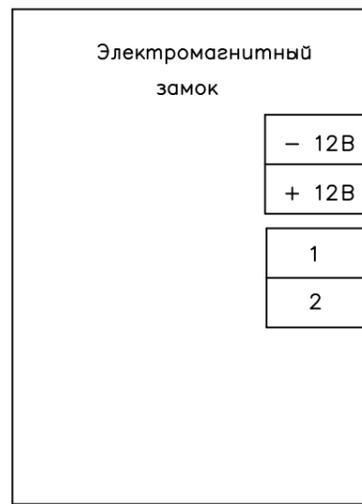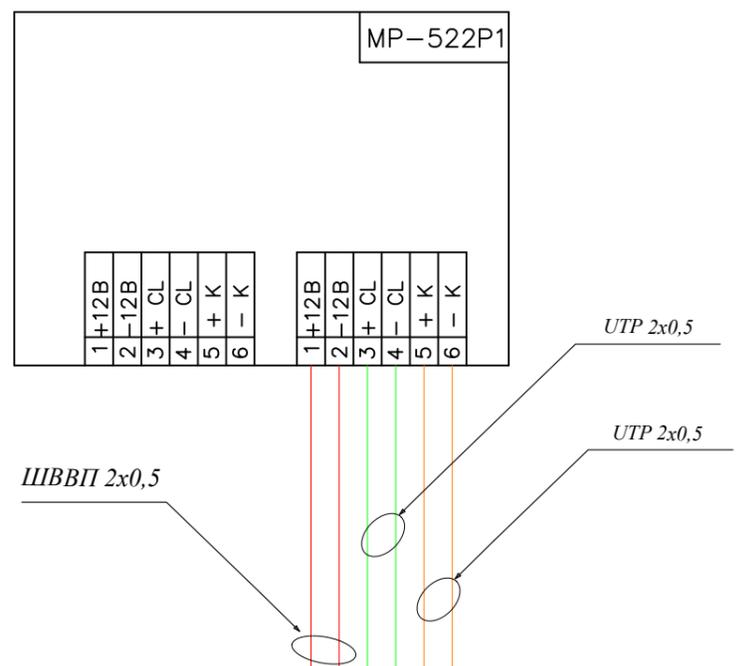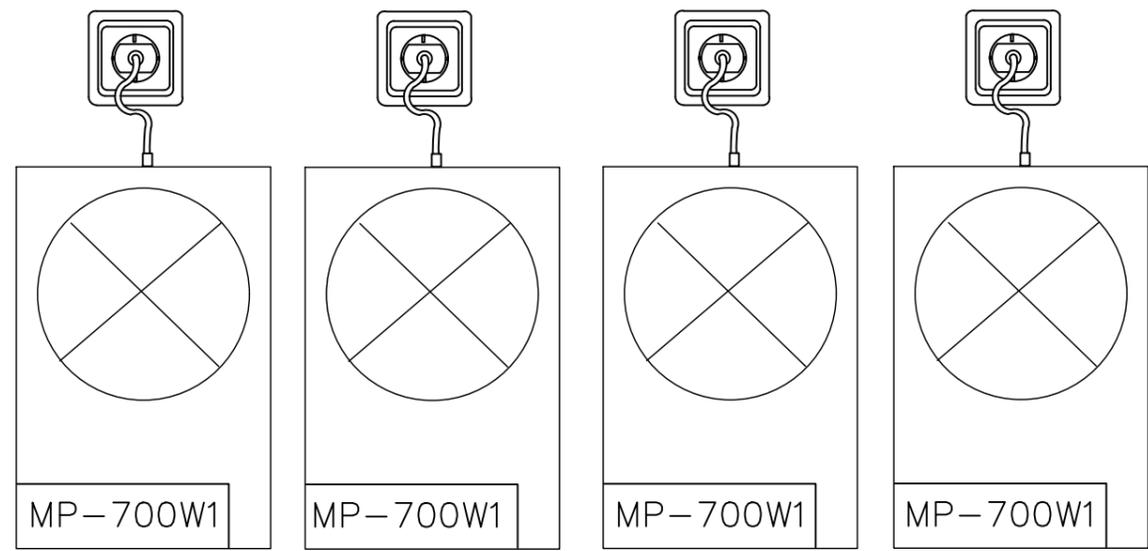

Цель электропитания — (Red line)  
 Интерфейс RS-485 — (Blue line)  
 Разговорный тракт — (Green line)  
 Силовая цель — (Orange line)

					Отделение кардиологии ЦРБ г. Озеры Московской обл.			
Изм.	Лист	№ докум.	Погр.	Дата	Система палатной сигнализации "HostCall-CMP" с разговорным трактом	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.						Лист 15	Листов	
Н.контр.					Структурная схема соединений оборудования входной группы в отделение			
Утв.								

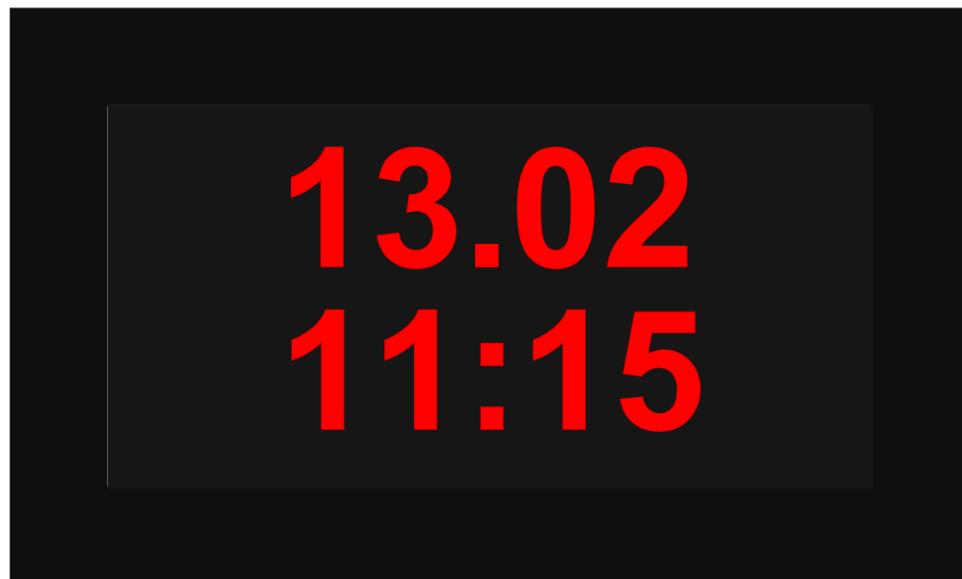


MP-761WA Табло отображения



MP-121D2 Пульт персонала с разговорным трактом



MP-511T2 Телефонная трубка

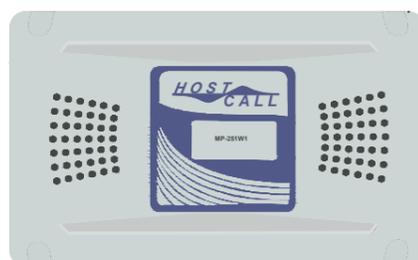


MP-251W4 Контроллер управления




MP-231G1 Контроллер передачи СМС-сообщений



MP-070W1 Коммутатор

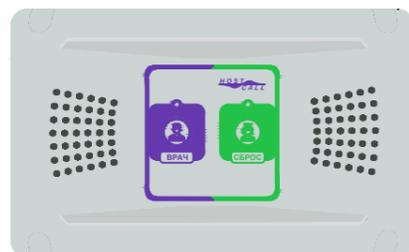

MP-331W1 Палатная консоль

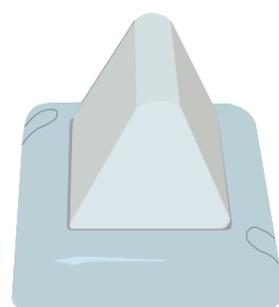

MP-611W1 Сигнальная лампа


					Отделение кардиологии ЦРБ г. Озеры Московской обл.		
Изм	Лист	№ докум.	Погр.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					Система палатной сигнализации "HostCall-CMP" с разговорным трактом		
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.					Лист 16	Листов	
Утв.					Внешний вид оборудования		




MP-432W2 Выводная  
кнопка вызова




MP-433W2 Влагозащищенная кнопка  
вызова со шнуром

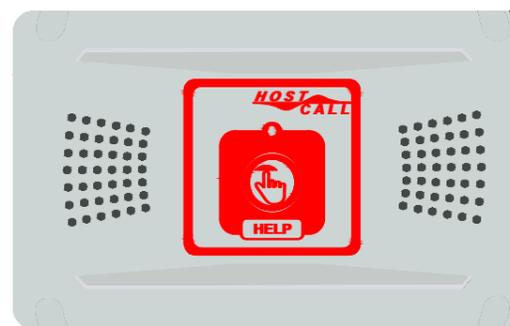

MP-522W1 Переговорное устройство

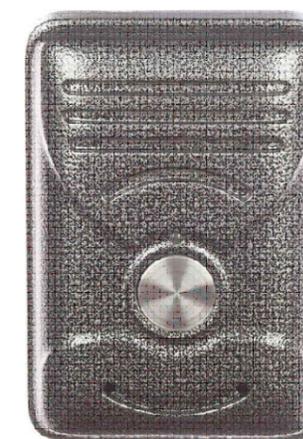

MP-522P1 Переговорное устройство

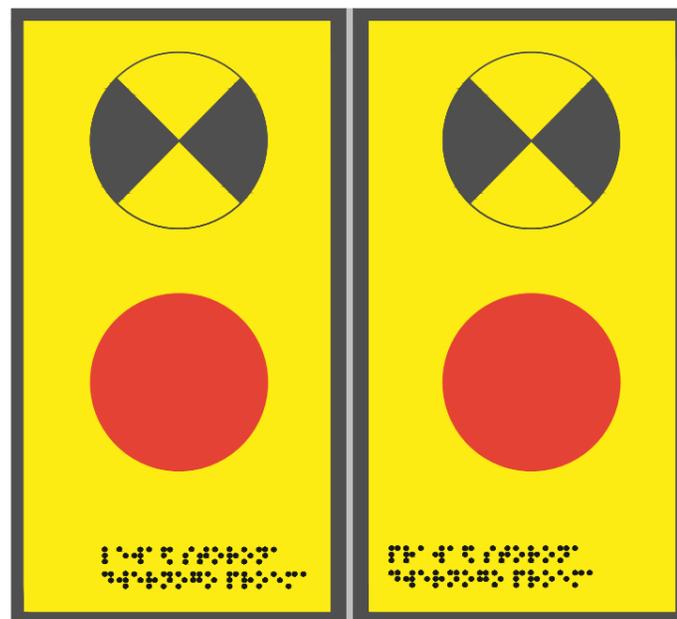

MP-700W1 Световой маяк для обозначения  
дверного проёма



ББП-50 исп.2 Блок бесперебойного питания



БП-1А Блок питания



MP-060W1 Дополнительная ручка со шнуром  
для кнопок вызова

					<i>Отделение кардиологии ЦРБ г. Озеры Московской обл.</i>			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<i>Система палатной сигнализации "HostCall-CMP" с разговорным трактом</i>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.								
Т.контр.						Лист 17	Листов	
Н.контр.					<i>Внешний вид оборудования</i>			
Утв.								

Перв. примен.	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание			
										1	2	3
		<i>Система палатной сигнализации "HostCall-CMP" с разговорным тактом</i>										
Справ. №	1	<i>MP-121D2 Пульт персонала с разговорным трактом</i>	<i>MP-121D2</i>		<i>ООО "СКБ Телси"</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>					
	2	<i>Персональный компьютер с установленным ПО "HostCall-Nurse-Statistics"</i>	<i>Workstation</i>		<i>ООО "СКБ Телси"</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>					
	3	<i>Монитор</i>	<i>Монитор</i>			<i>шт.</i>	<i>1</i>					
	4	<i>MP-511T2 Телефонная трубка</i>	<i>MP-511T2</i>		<i>ООО "СКБ Телси"</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>					
	5	<i>MP-761WA Табло отображения</i>	<i>MP-761WA</i>		<i>ООО "СКБ Телси"</i>	<i>шт.</i>	<i>4</i>					
	6	<i>MP-231G1 Контроллер передачи СМС-сообщений</i>	<i>MP-231G1</i>		<i>ООО "СКБ Телси"</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>					
	7	<i>Смартфон с предустановленным ПО "HostCall-Nurse-M"</i>	<i>Смартфон с "HostCall-Nurse-M"</i>		<i>ООО "СКБ Телси"</i>	<i>шт.</i>	<i>2</i>					
	8	<i>Сотовый телефон</i>	<i>Сотовый телефон</i>			<i>шт.</i>	<i>2</i>					
	9	<i>Контроллер TP-LINK</i>	<i>Контроллер TP-LINK</i>			<i>шт.</i>	<i>1</i>					
	10	<i>Точка доступа TP-LINK</i>	<i>Точка доступа TP-LINK</i>			<i>шт.</i>	<i>5</i>					
Погн. и дата	11	<i>MP-070W1 Коммутатор</i>	<i>MP-070W1</i>		<i>ООО "СКБ Телси"</i>	<i>шт.</i>	<i>3</i>					
	12	<i>MP-251W4 Контроллер управления</i>	<i>MP-251W4</i>		<i>ООО "СКБ Телси"</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>					
	13	<i>MP-700W1 Световой маяк для обозначения дверного проёма</i>	<i>MP-700W1</i>		<i>ООО "СКБ Телси"</i>	<i>компл.</i>	<i>2</i>					
	14	<i>MP-611W1 Сигнальная лампа</i>	<i>MP-611W1</i>		<i>ООО "СКБ Телси"</i>	<i>шт.</i>	<i>16</i>					
Инв. № дубл.	15	<i>MP-331W1 Палатная консоль</i>	<i>MP-331W1</i>		<i>ООО "СКБ Телси"</i>	<i>шт.</i>	<i>18</i>					
	16	<i>MP-522W1 Переговорное устройство</i>	<i>MP-522W1</i>		<i>ООО "СКБ Телси"</i>	<i>шт.</i>	<i>40</i>					
	17	<i>MP-432W2 Выносная кнопка вызова</i>	<i>MP-432W2</i>		<i>ООО "СКБ Телси"</i>	<i>шт.</i>	<i>35</i>					
	18	<i>MP-433W2 Влагозащищенная кнопка вызова со шнуром</i>	<i>MP-433W2</i>		<i>ООО "СКБ Телси"</i>	<i>шт.</i>	<i>14</i>					
Взам. инв. №	19	<i>Электромагнитный замок</i>	<i>Электромагнитный замок</i>			<i>шт.</i>	<i>1</i>					
	20	<i>MP-522P1 Переговорное устройство</i>	<i>MP-522P1</i>		<i>ООО "СКБ Телси"</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>					
	21	<i>MP-060W1 Дополнительная ручка со шнуром для кнопок вызова</i>	<i>MP-060W1</i>		<i>ООО "СКБ Телси"</i>	<i>шт.</i>	<i>3</i>					
Погн. и дата						<i>Отделение кардиологии ЦРБ г. Озеры Московской обл.</i>						
Инв. № подл.				Изм	Лист	№ докум.	Погн.	Дата	<i>Система палатной сигнализации "HostCall-CMP" с разговорным трактом</i>	Лит.	Масса	Масштаб
				Разраб.								
				Проб.								
				Т.контр.						Лист 18	Листов	
				Н.контр.						<i>Спецификация оборудования</i>		
				Утв.								

